



# 包装変更のご案内

## エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「日医工」 エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ1.0mL「日医工」 エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「日医工」

この度、『エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「日医工」』『エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ1.0mL「日医工」』『エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「日医工」』につきまして、包装を変更いたしますので、下記の通りご案内申し上げます。

今後ともより一層のご愛顧を賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

2022年3月

記

### 1 対象製品

エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「日医工」 1シリンジ

エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ1.0mL「日医工」 1シリンジ

エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「日医工」 1キット

(製造販売元：日医工株式会社)

### 2 お知らせ表示

包装変更品

### 3 変更内容

#### ■使用期限表示（シリンジ、ペン共通）


- ラベル・二次包装・個装箱の使用期限表示順（赤丸○部分）を変更（「年. 月」⇒「月. 年」）しました。

変更前	変更後
<p>例) 25mgシリンジ 個装箱</p> <p>製造番号 0E206NS (17)230400(10)0E206NS 使用期限 2023.04 (01)14987376038703</p>	<p>製造番号 Y100040 (17)240200(10)Y100040 使用期限 02.2024 (01)14987376038703</p>

【エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「日医工」/50mgシリンジ1.0mL「日医工」】

## ■シリンジ

- ・バックストップアダプター (①) およびプランジャーロッド (②) の形状を変更しました。
- ・ラベルの製造番号・使用期限の印字仕様を変更 (「墨ベタ・白抜き文字」⇒「白ベタ・墨文字」) しました。

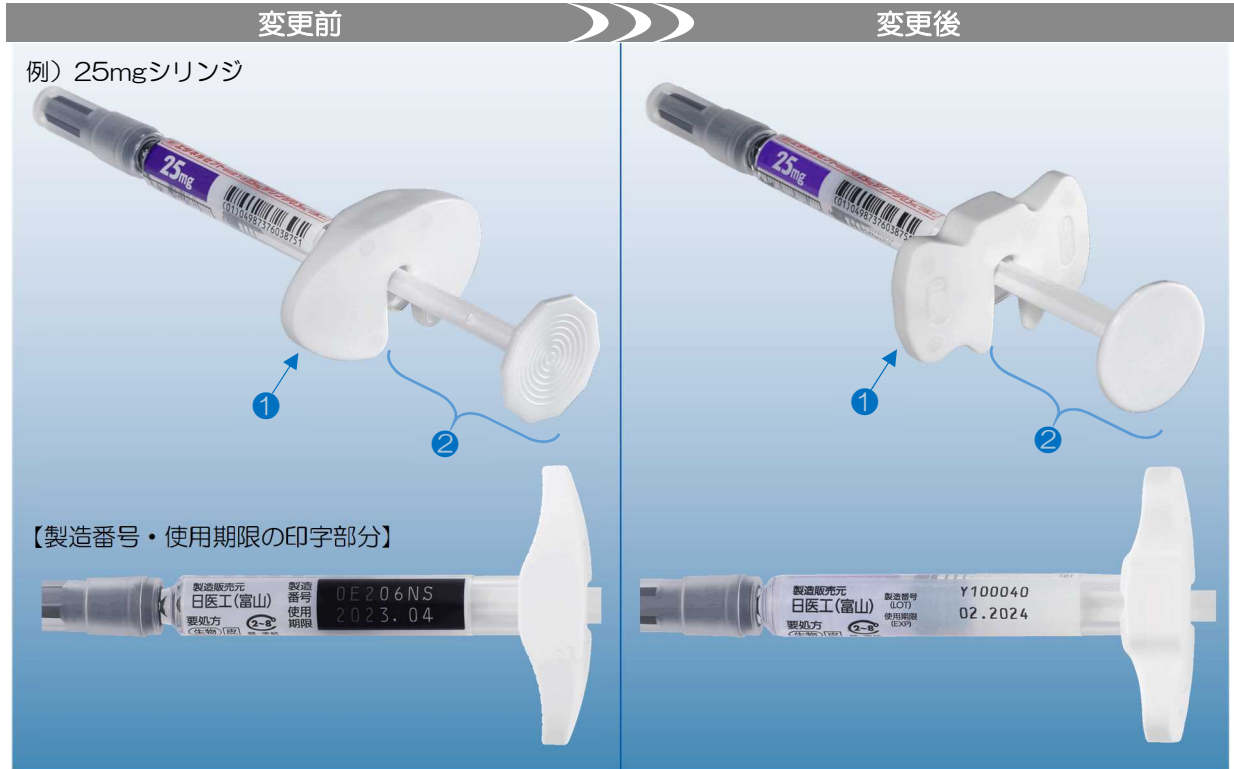

## ■ブリスターパック (二次包装)

- ・形状およびトップシールを変更 (フィルム⇒メディカルグレードペーパー) しました。
- ・開封口の位置 (右端上下⇒左端上下) およびシリンジの格納方向 (針が左側⇒針が右側) を変更しました。
- ・製造番号・使用期限 (赤矢印 ➡ 部分) について「トップシール窓枠からシリンジの印字 (墨ベタ・白抜き文字) が見える仕様」から「トップシールへの直接印字 (白ベタ・墨文字)」に変更しました。
- ・トップシールに、「注射針のキャップはまっすぐ引き抜くこと」(青ベタ・白抜き文字) を追記しました。(赤丸○部分)



## 【エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「日医工」】

## ■ペン

- ・ラベルサイズ（40×30⇒55×55（mm））および貼付方向（針が左側⇒針が右側）を変更しました。
- ・ラベルの製造番号・使用期限の印字仕様を変更（「墨ベタ・白抜き文字」⇒「白ベタ・墨文字」）しました。




## ■二次包装

- ・包装仕様を「ピロー」⇒「プリスターパック（トップシールはメディカルグレードペーパー）」へ変更しました。



■個装箱（シリンジ、ペン共通）

- ・サイズを変更しました。
- ・開封口（赤丸○部分）の位置（底面右側⇒底面左側）および形状を変更しました。
- ・集中表示および製造番号・使用期限の印字位置を変更（正面⇒背面）しました。

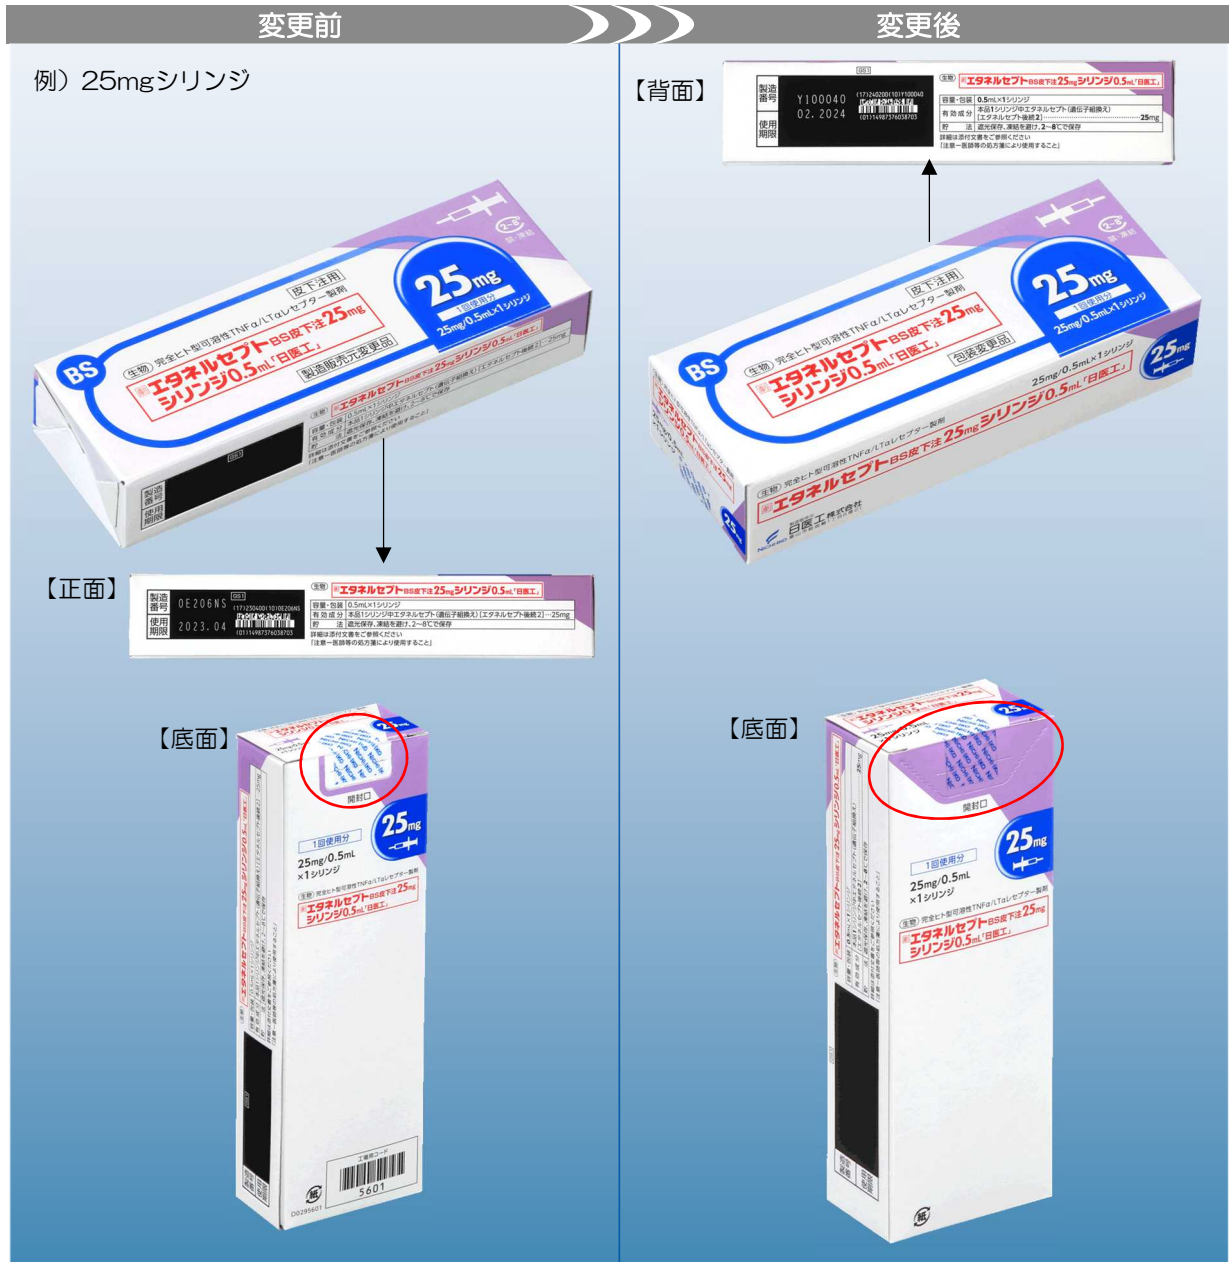

■サイズ・重量・入数

製品名		変更前			変更後		
		サイズ(mm)	重量(g)	入数	サイズ(mm)	重量(g)	入数
エタネルセプトBS 皮下注25mgシリンジ 0.5mL「日医工」	個装箱	163×53×29	31	-	160×58×36	35	-
	元梱包	337×284×166	1,907	50	380×192×315	2,200	50
エタネルセプトBS 皮下注50mgシリンジ 1.0mL「日医工」	個装箱	163×53×29	31	-	160×58×36	35	-
	元梱包	337×284×166	1,937	50	380×192×315	2,200	50
エタネルセプトBS 皮下注50mgペン 1.0mL「日医工」	個装箱	163×53×29	45	-	164×58×35	55	-
	元梱包	337×284×166	2,597	50	380×192×315	3,200	50

**4 変更開始製造番号と出荷予定時期**

製品名	包装規格	統一商品コード 販売包装単位コード	製造番号 (使用期限)	出荷予定時期
エタネルセプトBS皮下注25mg シリンジ0.5mL「日医工」	1シリンジ	376-03870-6 14987376038703	Y100040 (2024年2月)	2022年9月中旬
エタネルセプトBS皮下注50mg シリンジ1.0mL「日医工」	1シリンジ	376-03880-5 14987376038802	Y200013 (2024年7月)	2022年5月下旬
エタネルセプトBS皮下注50mg ペン1.0mL「日医工」	1キット	376-03890-4 14987376038901	Y100062 (2024年2月)	2022年3月下旬

- 流通在庫の関係から出荷予定時期が前後することがありますが、何卒ご了承ください。

以上