



包装変更のご案内

ジルチアゼム塩酸塩静注用10mg「日医工」

この度、弊社販売の『ジルチアゼム塩酸塩静注用10mg「日医工」』につきまして、包装を変更致しましたので、下記の通りご案内申し上げます。

今後ともより一層のご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

2018年12月

記

1 対象製品


ジルチアゼム塩酸塩静注用10mg「日医工」 10mg×10アンプル

(製造販売元：日医工ファーマ株式会社)

2 変更内容

■アンプル

- ・形状を変更しました。

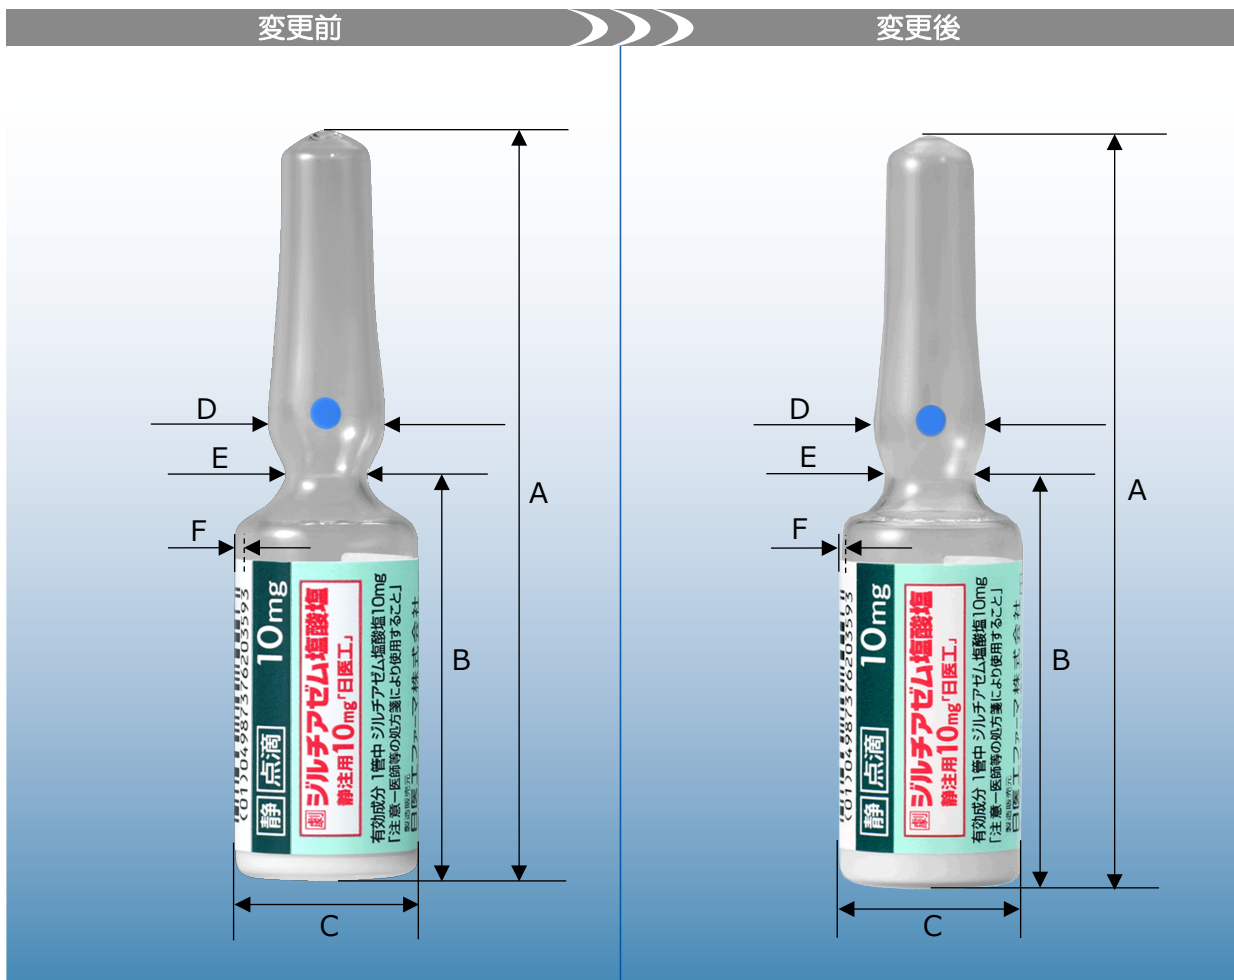

	変更前	変更後
A:全長	60.0±2.0	変更なし
B:胴長	31.7±0.8	32.0±0.7
C:胴径	φ14.5±0.3	φ14.4±0.2
D:玉径	φ9.0±0.8	φ9.3±0.7
E:絞り径	φ6.5±0.5	φ7.2±0.5
F:肉厚	0.53±0.03	0.48±0.05

(単位: mm)

3 お知らせ表示

アンプル変更品

4 変更ロットと出荷開始時期

品名	包装規格	統一商品コード	変更ロット (使用期限)	出荷開始時期
ジルチアゼム塩酸塩静注用 10mg「日医工」	10mg×10アンプル	376-20350-0	GU2300 (2021年7月)	2019年3月下旬

・流通在庫の関係から予定時期が前後することがありますが、何卒ご了承ください。

以上