



# 包装変更のご案内

## レボホリナート点滴静注用100mg「日医工」

この度、弊社販売の『レボホリナート点滴静注用100mg「日医工」』につきまして、包装を変更致しましたので、下記の通りご案内申し上げます。

今後ともより一層のご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

2019年1月

記


### 1 対象製品

レボホリナート点滴静注用100mg「日医工」 100mg×10バイアル

### 2 変更内容

#### ■バイアル瓶


- ・サイズを変更しました。

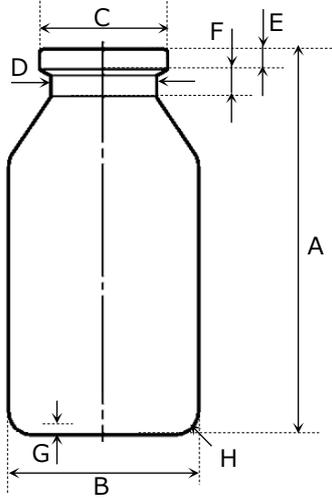変更前	変更後		
			
		変更前	変更後
A: 全長		60±0.5	変更なし
B: 胴径		φ30.0±0.5	変更なし
C: 口外径		φ19.7±0.3	変更なし
D: 首外径		φ16.3±0.3	φ16.1±0.3
E: ツバ厚		3.9±0.3	4.1±0.3
F: 首丈		3.5±0.3	4.0±0.3
G: 底肉厚		0.9	0.8
H: 底角R		3.5	2.5

(単位: mm)

### ■ゴム栓

- ・色調、サイズ、形状を変更しました。

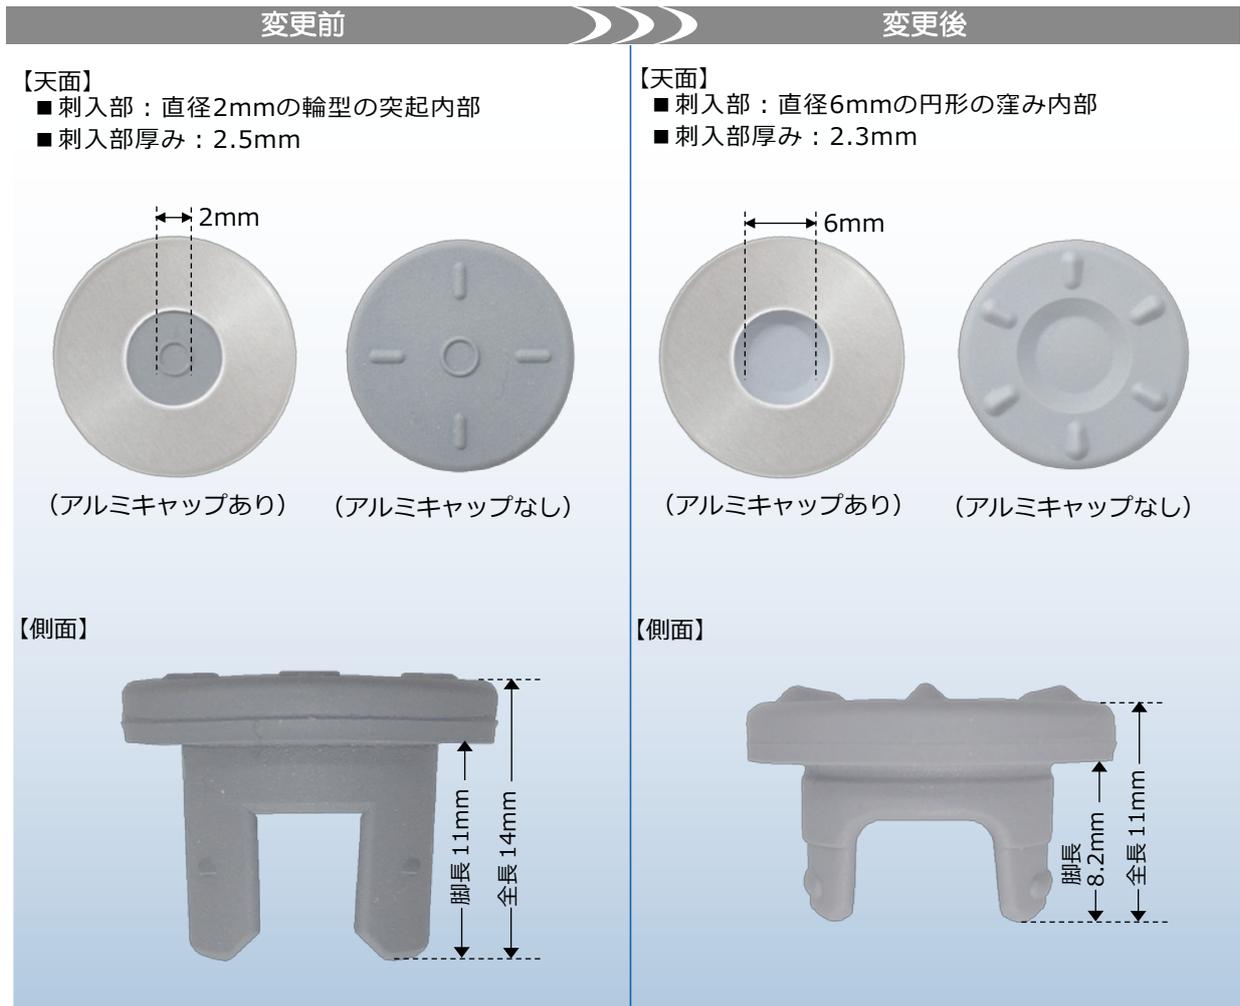

### 3 お知らせ表示

なし

### 4 変更ロットと出荷開始時期

製品名	包装規格	統一商品コード	変更ロット (使用期限)	出荷開始時期
レボホリナート点滴静注用 100mg「日医工」	100mg×10バイアル	376-21861-0	LD2000 (2020年12月)	2019年4月上旬

- ・流通在庫の関係から予定時期が前後することがありますが、何卒ご了承ください。

以上